

(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 941 014 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

08.09.1999 Patentblatt 1999/36

(51) Int. Cl.⁶: H04R 25/00

(21) Anmeldenummer: 99103207.9

(22) Anmeldetag: 18.02.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 03.03.1998 DE 19808996

01.12.1998 DE 19855483

09.02.1999 DE 19905330

(71) Anmelder:

Siemens Audiologische Technik GmbH
91058 Erlangen (DE)

(72) Erfinder:

• Holube, Inga Dr.
91052 Erlangen (DE)

• Meyer, Wolfram Dipl.-Ing.

91096 Möhrendorf (DE)

• Husung, Kunibert Dipl.-Ing.

91052 Erlangen (DE)

• Gebert, Anton Dipl.-Ing.

91077 Kleinsendelbach (DE)

• Sporer, Gerhard Dipl.-Ing.

91207 Lauf (DE)

(74) Vertreter:

Epping, Wilhelm, Dr.-Ing. et al
Patentanwalt
Postfach 22 13 17
80503 München (DE)

(54) Hörgerätesystem mit zwei Hörhilfegeräten sowie Verfahren zum Betrieb eines solchen Hörgerätesystems

(57) Durch die Betätigung eines Bedienelementes (5, 5', 6, 6') an einem der beiden Hörhilfegeräte (1, 1') des Hörgerätesystems wird ein Steuersignal erzeugt und auf das zweite Hörhilfegerät übertragen, was zu einer simultanen Anpassung der beiden Hörhilfegeräte durch dieses Steuersignal und die hörgeräteeigenen Signalverarbeitungseinheiten führt. Eine weitere Vereinfachung des Hörgerätesystems wird dadurch erreicht, daß Mittel zur Verarbeitung der Audiosignale auf die Hörhilfegeräte verteilt sind.

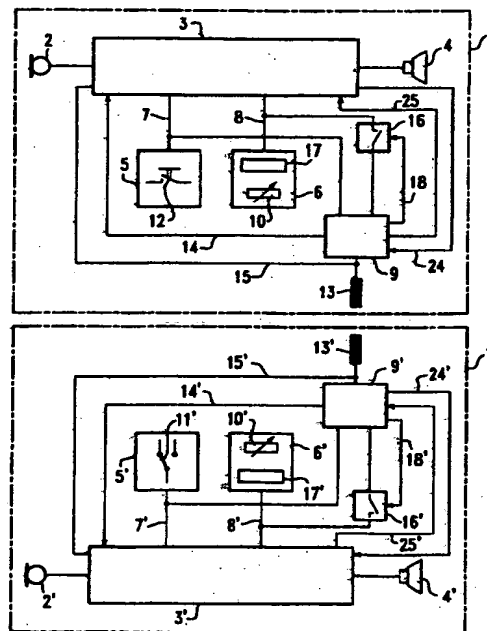


FIG 1

EP 0 941 014 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hörgerätesystem zur binauralen Versorgung mit zwei Hörhilfegeräten, mit Mikrofonen, Signalverarbeitungseinheiten, Hörern und Bedienelementen, wobei zwischen den Hörhilfegeräten ein Signalaustausch vorgesehen ist.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betrieb eines solchen Hörgerätesystems.

[0003] Ein Hörgerätesystem dieser Art ist aus der DE 23 60 342 C2 bekannt. Bei diesem Hörgerätesystem mit zwei Hörhilfegeräten, die jeweils ein Mikrofon, einen Hörer und eine Signalverarbeitungseinheit aufweisen, ist bei einem der Hörhilfegeräte der Hörer gegen eine Induktionsspule ausgetauscht. Beim anderen der beiden Hörhilfegeräte ist ebenfalls eine Induktionsspule vorgesehen, für den Empfang mit der Hörspule des ersten Hörgerätes. Damit besteht zwischen den beiden Hörhilfegeräten des Hörgerätesystems eine drahtlose Verbindung zum Austausch von Signalen.

[0004] Aus der DE 43 27 901 C1 ist ein Hörgerätesystem mit zwei Hörhilfegeräten und einer räumlich von diesen getrennten Steuereinheit bekannt. Zwischen den Hörhilfegeräten und der Steuereinheit besteht eine drahtlose Verbindung zum Austausch von Audiosignalen.

[0005] Ferner wird in der DE 19 38 381 A1 ein Hörhilfegerät beschrieben, bei dem die Lautstärkeregelung mittels einer drahtlosen Fernbedienung erfolgt.

[0006] Bekannte Hörgerätesysteme mit zwei Hörhilfegeräten, bei denen ein Signalaustausch zwischen den beiden Hörhilfegeräten vorgesehen ist, haben den Nachteil, daß es zur individuellen Anpassung des Hörgerätesystems, beispielsweise bezüglich der Lautstärkeregelung oder der Wahl des Hörprogramms, einer separaten Bedienung beider Hörhilfegeräte bedarf. Wird eine Fernbedienung verwendet, die auf beide Hörhilfegeräte gleichermaßen wirkt, so ist es nachteilig, weil diese stets mitgeführt werden muß. Ferner umfassen die Hörhilfegeräte der bekannten Hörgerätesysteme aufwendige Signalverarbeitungseinheiten.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Hörgerätesystem der eingangs genannten Art bezüglich seiner Hörhilfegeräte zu vereinfachen sowie ein Verfahren zum Betrieb eines derartigen Hörgerätesystems anzugeben.

[0008] Nach der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß zumindest von einem Bedienelement zum Anpassen des einen Hörhilfegerätes erzeugte Steuersignale auf das zweite Hörhilfegerät übertragbar sind und eine simultane Anpassung der beiden Hörhilfegeräte durch diese Steuersignale und die hörgeräteeigenen Signalverarbeitungseinheiten vorgesehen ist. Gemäß der Erfindung wird damit eine wesentliche Vereinfachung in der Bedienung und/oder der Ausstattung des Hörgerätesystems erreicht.

[0009] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätesystems der eingangs genannt-

ten Art werden die von den Bedienelementen zum Anpassen des einen Hörhilfegerätes erzeugten Steuersignale auf das zweite Hörhilfegerät übertragen und die beiden Hörhilfegeräte sind durch diese Steuersignale und die hörgeräteeigenen Signalverarbeitungseinheiten simultan anpaßbar.

[0010] Bekannte Bedienelemente bei Hörhilfegeräten sind beispielsweise; Ein-Ausschalter, Eingangs-Wahlschalter für Mikrofon oder Hörspule, Verstärkungssteller, Klangblende, Mikrofonschalter oder Programmwahlschalter. Die Bedienelemente ermöglichen die Anpassung der Hörhilfegeräte an den Bedarfsfall. Sie können schrittweise (z.B. Schalter) oder kontinuierlich (z.B. Stellenwiderstände) verstellbar sein.

[0011] Die Erfindung realisiert die Funktion einer Fernbedienung, vermeidet aber deren Nachteile, da die Sendeeinheit mit im Hörhilfegerät integriert ist. Die Erfindung hat den Vorteil, daß keine separate Fernbedienung mitgeführt werden muß. Zur Anpassung der beiden Hörhilfegeräte genügt es, eines der beiden Hörhilfegeräte zu bedienen. Dies ist insbesondere beim Umschalten in ein anderes Hörprogramm von Vorteil. Bei herkömmlichen Hörgerätesystemen kann es vorkommen, daß eines der beiden Geräte im falschen Hörprogramm betrieben wird. Besonders nachteilig wirkt sich dies aus, wenn z.B. das eine Gerät mit Richtmikrofon und das andere omnidirektional betrieben wird. Totale Desorientierung könnte die Folge sein.

[0012] Ein Hörgerätesystem nach der Erfindung ermöglicht ein simultanes Umschalten beider Geräte und vermeidet damit die Nachteile herkömmlicher Lösungen.

[0013] Nach einer Ausführungsform der Erfindung umfaßt das Hörgerätesystem zwei Hörhilfegeräte, die hinsichtlich ihrer Bedienelemente übereinstimmen und sich von herkömmlichen Hörhilfegeräten dadurch unterscheiden, daß zumindest bei einem der Bedienelemente eine Übertragung der durch die Betätigung erzeugten Steuersignale zum anderen Hörhilfegerät erfolgt. Dies hat den Vorteil, daß die Erfindung bei Hörhilfegeräten ohne Änderung der heute üblichen Gehäuse angewandt werden kann. Wird an einem der beiden Hörhilfegeräte ein Bedienelement betätigt, so werden nach der Erfindung beide Hörhilfegeräte entsprechend angepaßt.

[0014] Eine weitere Variante der Erfindung sieht vor, die Bedienelemente zumindest teilweise auf beide Hörhilfegeräte aufzuteilen. Dies hat zur Folge, daß damit nicht mehr jede Art von Bedienelementen an jedem der Hörhilfegeräte vorhanden ist und damit insgesamt weniger Platzbedarf für die Anbringung von Bedienelementen erforderlich ist, wodurch die verbleibenden Bedienelemente entsprechend größer ausgeführt oder, bei unveränderter Größe der Bedienelemente, die Gehäuse der Hörhilfegeräte entsprechend verkleinert werden können.

[0015] Eine besonders bevorzugte Variante der Erfindung sieht vor, daß bei beiden Hörhilfegeräten je ein

Lautstärkeregler vorhanden ist, bei dessen Betätigung es nicht zu einem Signalaustausch gemäß der Erfindung kommt, so daß sich die Verstärkung bei beiden Hörhilfegeräten separat einstellen läßt, was einer unterschiedlichen Hörschwäche der beiden Ohren eines Hörgeräteträgers Rechnung trägt. Weitere Bedienelemente wie beispielsweise der Eingangswahlschalter für Mikrofon oder Hörspule, der Klangregler oder der Programmwahlschalter sind gemäß der Erfindung auf beide Hörhilfegeräte verteilt. Die Betätigung eines der letztgenannten Bedienelemente führt damit zu einer simultanen Anpassung beider Hörhilfegeräte.

[0016] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung sieht vor, alle Bedienelemente an nur einem der beiden Hörhilfegeräte anzubringen, was zu einer sehr kostengünstigen Variante führt und bei dem Hörhilfegerät ohne Bedienelemente eine sehr kleine Bauform ermöglicht.

[0017] Eine weitere erfindungsgemäße Variante des Hörgerätesystems sieht vor, daß zumindest bei einigen der Bedienelemente die Wahlmöglichkeit besteht, ob bei einer Betätigung dieser Bedienelemente eine Anpassung des anderen Hörhilfegerätes erfolgt. Derartige Einstellungen können beispielsweise bei der Programmierung des Hörgerätesystems festgelegt werden. Dies erhöht die Zahl der Anwendungsmöglichkeiten für Hörgerätesysteme nach der Erfindung bei gleichzeitiger Reduzierung der Gerätevarianten. So kann beispielsweise nach der Erfindung ein und dasselbe Hörhilfegerät bei einem Hörgeräteträger mit beidseitig gleich ausgeprägter Gehörschwäche eingesetzt werden, der die Lautstärkeregelung nur an einem der beiden Hörhilfegeräte zu verändern wünscht und sich diese Veränderung dann auf beide Hörhilfegeräte gleichermaßen auswirkt. Des weiteren kann das gleiche Hörhilfegerät auch bei einem Hörgeräteträger mit unterschiedlich ausgeprägter Gehörschwäche eingesetzt werden, der die Lautstärke beider Geräte individuell anzupassen wünscht.

[0018] Eine erfindungsgemäße Lösung der gestellten Aufgabe, ein Hörgerätesystem bezüglich seiner Hörhilfegeräte zu vereinfachen, ist ferner dadurch gekennzeichnet, daß nur eines der beiden Hörhilfegeräte Mittel zur Signalverarbeitung aufweist, welche vom Mikrofon dieses Hörhilfegerätes sowie vom Mikrofon des zweiten Hörhilfegerätes empfangene und an das erste Hörhilfegerät übertragene Audiosignale verarbeiten, und wobei verarbeitete Audiosignale dem eigenen Hörer bzw. nach einer Übertragung verarbeiteter Audiosignale an das zweite Hörhilfegerät diese dem Hörer des zweiten Hörhilfegerätes zuführbar sind. Gemäß der Erfindung sind bei einem solchen Hörgerätesystem Hörhilfegeräte mit vereinfachten Signalverarbeitungseinheiten verwendbar.

[0019] Die Verarbeitung der von den Mikrofonen beider Hörhilfegeräte aufgenommenen Audiosignale in nur einer Signalverarbeitungseinheit bietet außer der kleineren Baugröße eines der beiden Hörhilfegeräte noch

weitere Vorteile. So lassen sich durch die gemeinsame Verarbeitung der von beiden Hörhilfegeräten aufgenommenen Audiosignale das räumliche Hören und die Unterdrückung von Störgeräuschen wesentlich verbessern. Darüber hinaus ist durch den Wegfall einer Signalverarbeitungseinheit in einer der Hörhilfegeräte auch eine Kostenersparnis möglich. Der äußere Aufbau des betreffenden Hörhilfegerätes kann entsprechend kleiner und leichter ausgeführt werden und auch der Stromverbrauch sinkt, wodurch die Kapazität und damit die Größe der Spannungsquelle entsprechend angepaßt werden kann.

[0020] Nach einer weiteren Variante der Erfindung erfolgt für die von den jeweiligen Mikrofonen der Hörhilfegeräte empfangenen Audiosignale zunächst eine Signalvorverarbeitung, bevor sie einer gemeinsamen Signalverarbeitungseinheit zugeführt werden. Diese Signalvorverarbeitung umfaßt beispielsweise eine AD-Wandlung mit Bandpaßfilterung.

[0021] Entsprechend werden nach einer Ausführungsform die verarbeiteten Audiosignale des jeweiligen Hörhilfegerätes nachverarbeitet, bevor sie den Hörern zugeführt werden. Diese Signalnachverarbeitung umfaßt beispielsweise eine DA-Wandlung und Verstärkung.

[0022] Der Wunsch nach möglichst kleinen Bauformen der Hörhilfegeräte läßt sich nach der Erfindung am besten dadurch realisieren, daß der überwiegende Teil der Bedienelemente des Hörgerätesystems nicht an dem Hörhilfegerät angeordnet ist, welches die Mittel zur Signalverarbeitung der von beiden Mikrofonen empfangenen Audiosignale aufweist. Da bei diesem Hörhilfegerät die verbleibende Signalverarbeitungseinheit gegenüber der Signalverarbeitungseinheit des anderen Hörhilfegerätes wesentlich kleiner und leistungsschwächer ausgeführt ist, wird dafür weniger Platz beansprucht. Als weitere Folge ist auch der Energieverbrauch dieses Hörhilfegerätes wesentlich reduziert, womit die Spannungsquelle entsprechend kleiner dimensioniert werden kann. Durch diese Effekte wird der erhöhte Platzbedarf für die größere Anzahl an Bedienelementen an diesem Hörhilfegerät kompensiert. Insgesamt läßt sich somit die Bauform beider Hörhilfegeräte verkleinern.

[0023] Zur Übertragung der Audio- und/oder Steuersignale zwischen den Hörhilfegeräten weisen diese entsprechende Mittel zum Senden und/oder Empfangen derartiger Signale auf. Es sind alle für die Übertragung üblichen Methoden denkbar. So sieht eine Variante der Erfindung eine drahtgebundene Übertragung und eine andere Variante eine drahtlose Übertragung, beispielsweise in Form elektromagnetischer Wellen, vor. Nach der Erfindung kann es sich bei den übertragenen Signalen sowohl um analoge als auch digitale Signale handeln.

[0024] Besonders einfach und kostengünstig erfolgt nach der Erfindung der Austausch der Audio- und/oder Steuersignale über an jedem der Hörhilfegeräte befind-

liche Mittel zum Senden und/oder Empfangen dieser Signale in Verbindung mit je einer Telefonspule, wie sie bei üblichen Hörhilfegeräten zur induktiven Aufnahme magnetischer Nutzsignale bereits vorhanden ist. Damit wird der Aufwand an zusätzlichen Bauteilen zur Ausführung der Erfindung auf ein Minimum begrenzt. Zusätzlich zum Senden und/oder Empfangen der Audio- und/oder Steuersignale gemäß der Erfindung oder zum Übertragen von Nutzsignalen kann über die Telefonspulen auch die drahtlose Programmierung oder Fernbedienung der Hörhilfegeräte erfolgen.

[0025] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Ausführungsbeispiele anhand der Zeichnung und in Verbindung mit den Patentansprüchen.

[0026] Es zeigen:

Figur 1 die Blockschaltbilder zweier Hörhilfegeräte eines Hörgerätesystems nach der Erfindung,

Figur 2 die Blockschaltbilder zweier Hörhilfegeräte, zwischen denen ein Austausch von Audiosignalen vorgesehen ist,

Figur 3 das Gehäuse eines ersten Hörhilfegerätes nach der Erfindung,

Figur 4 das Gehäuse eines zweiten Hörhilfegerätes nach der Erfindung.

[0027] Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung ein Hörgerätesystem mit zwei Hörhilfegeräten 1 und 1'. Beide Hörhilfegeräte weisen jeweils ein Mikrofon 2, 2', eine Signalverarbeitungseinheit 3, 3', sowie einen Hörer 4, 4' auf. Ferner sind am Hörhilfegerät 1 die Bedienelemente 5 und 6 angeordnet. Das Bedienelement 5 umfaßt einen Taster 12, der es ermöglicht, zwischen unterschiedlichen Hörprogrammen zu wählen. Stehen beispielsweise drei Hörprogramme zur Auswahl, so kann durch Tastendruck in das nächste Programm gewechselt werden. Eine mögliche Schaltfolge der Programme 1 bis 3 wäre 1-2-3-1. Das durch die Betätigung des Tasters 12 erzeugte Steuersignal 7 wird in analoger oder digitaler Form an die Signalverarbeitungseinheit 3 weitergeleitet. Darüber hinaus wird das Steuersignal 7 auch an die Sende- und/oder Empfangseinheit 9 geführt. Das Bedienelement 6 dient der Lautstärkeregelung. Es umfaßt einen Verstärkungssteller 10 sowie einen AD-Wandler mit Speicher 17. Das resultierende Steuersignal 8 wird auch hier an die Signalverarbeitungseinheit 3 sowie die Sende- und/oder Empfangseinheit 9 weitergeleitet. Im Gegensatz zum Bedienelement 5 erfolgt hier jedoch die Weiterleitung zur Sende- und/oder Empfangseinheit 9 über den programmierbaren Schalter 16. Die Programmierung des Schalters 16 erfolgt über das Steuersignal 8. Zum Senden und/oder Empfangen der elektromagnetischen Nutzsignale 15 sowie der elektromagnetischen Steuersignale dient die

Telefonspule 13. Durch Öffnen und Schließen des Schalters 16 kann festgelegt werden, ob die Lautstärkeeinstellung von einem Hörhilfegerät zum anderen übertragen wird.

[0028] Während beim Hörhilfegerät 1 das Bedienelement 5 als Programmwahlschalter dient und einen Taster 12 aufweist, dient das Bedienelement 5' beim Hörhilfegerät 1' als Eingangswahlschalter für Mikrofon oder Hörspule und weist hierzu einen Schiebeschalter 11' mit zwei stabilen Endstellungen auf. Das durch die Betätigung des Bedienelementes 5' erzeugte Steuersignal 7' wird zur Signalverarbeitungseinheit 3' sowie zur Sende- und/oder Empfangseinheit 9' geleitet. Über die Sende- und/oder Empfangseinheit 9' und die Telefonspule 13' wird das Steuersignal 7' vom Hörhilfegerät 1' auf das Hörhilfegerät 1' übertragen. Dort wird es über die Telefonspule 13 und die Sende- und/oder Empfangseinheit 9 als Steuersignal 14 der Signalverarbeitungseinheit 3 zugeführt. Entsprechend wird das Steuersignal 7 des Hörgerätes 1 über die Sende- und/oder Empfangseinheit 9 und die Telefonspule 13 an das Hörhilfegerät 1' übertragen und dort über die Telefonspule 13' und die Sende- und/oder Empfangseinheit 9' als Steuersignal 14' der Signalverarbeitungseinheit 3' zugeführt.

[0029] Zwischen den beiden Hörhilfegeräten 1 und 1' ist neben dem Austausch von Steuersignalen auch eine Übertragung von Audiosignalen vorgesehen. Hierzu wird das von der Signalverarbeitungseinheit 3 kommende Audiosignal 24 zu der Sende- und/oder Empfangseinheit 9 geleitet. Von der Sende- und/oder Empfangseinheit 9' des Hörhilfegerätes 1' wird dieses vom Hörhilfegerät 1 gesendete Audiosignal empfangen und als Audiosignal 24' der Signalverarbeitungseinheit 3' des Hörhilfegerätes 1' zugeführt. Im Gegenzug wird das in der Signalverarbeitungseinheit 3' erzeugte, verarbeitete Audiosignal 25 mittels der Sende- und/oder Empfangseinheiten 9' und 9 auf das Hörhilfegerät 1 übertragen und dort als verarbeitetes Audiosignal 25 der Signalverarbeitungseinheit 3 zugeführt.

[0030] Des weiteren kann das erfindungsgemäße Hörgerätesystem von dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel im Rahmen der Erfindung abweichen. Beispielsweise ist jede beliebige Auswahl und Aufteilung von Bedienelementen denkbar. Auch die Signalführung muß nicht notwendigerweise mit dem Ausführungsbeispiel übereinstimmen. Beispielsweise könnte unter Verzicht auf die Sende- und/oder Empfangseinheiten 9 und 9' der Signalaustausch direkt zwischen den Bedienelementen 5, 5', 6, 6' erfolgen, wenn diese jeweils entsprechende Mittel zur Signalübertragung aufweisen. Es ist auch möglich, daß die Einstellungen aller Bedienelemente eines Hörgerätes in einem gemeinsamen Speicher zusammengeführt sind und die Einstellparameter eines Hörhilfegerätes in ihrer Gesamtheit zum zweiten Hörhilfegerät übertragen werden.

[0031] Abweichend von obigem Ausführungsbeispiel

muß die Signalübertragung auch nicht über die beiden Telefonspulen 13 und 13' erfolgen, sondern es ist jede beliebige Möglichkeit der Signalübertragung, beispielsweise drahtgebunden, möglich.

[0032] Im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2 ist in grob schematischer Darstellung der Verlauf der Audiosignale durch ein Hörgerätesystem nach der Erfindung dargestellt, wobei zwischen den beiden Hörhilfegeräten 1 und 1' eine Übertragung von Audiosignalen vorgesehen ist.

[0033] Die vom Mikrofon 2 des Hörhilfegerätes 1 aufgenommenen Audiosignale werden durch Mittel 22 zur Vorverarbeitung von Audiosignalen, beispielsweise AD-Wandlung mit Bandpaßfilterung, als Audiosignale 20 an das Hörhilfegerät 1' übertragen. Dort werden sie gemeinsam mit den vom Mikrofon 2' aufgenommenen und von den Mitteln 22' zur Vorverarbeitung von Audiosignalen vorverarbeiteten Audiosignalen des Hörhilfegerätes 1' von Mitteln 19 zur Verarbeitung von Audiosignalen verarbeitet. Hier findet im wesentlichen die zum binauralen Hören erforderliche Signalverarbeitung statt. Dadurch, daß die von beiden Hörhilfegeräten aufgenommenen Audiosignale gemeinsam in einer einzigen Signalverarbeitungseinheit vorliegen, können hierin beispielsweise sehr effiziente Algorithmen zur Verbesserung des Richtungshörens und zur Störsignalunterdrückung Anwendung finden. Im Anschluß daran werden die das Hörhilfegerät 1 betreffenden, verarbeiteten Audiosignale 21 an das Hörhilfegerät 1 übertragen und dort von Mitteln 23 zur Nachverarbeitung von Audiosignalen, beispielsweise DA-Wandlung und Verstärkung, nachverarbeitet und an den Hörer 4 weitergeleitet. Entsprechend werden die das Hörhilfegerät 1' betreffenden, verarbeiteten Audiosignale 21' den Mitteln 23' zur Nachverarbeitung von Audiosignalen zugeführt und an den Hörer 4' weitergeleitet.

[0034] Das dargestellte Ausführungsbeispiel dient nur der prinzipiellen Verdeutlichung der Erfindung und umfaßt eine Vielzahl an Varianten. So kann es sich bei den dargestellten Hörhilfegeräten um ein- oder mehrkanalige Geräte handeln, die Signalverarbeitung kann in analoger oder digitaler Weise erfolgen, usw. Auch die Signalverarbeitung läßt eine Vielzahl an Variationen zu. Wesentlich für die Erfindung ist, daß ein Teil der Signalverarbeitung in nur einem der beiden Hörhilfegeräte möglich ist und das andere Hörhilfegerät somit entsprechend einfacher aufgebaut ist.

[0035] In Figur 3 und 4 ist eine mögliche Außenansicht der Hörhilfegeräte 1 und 1' dargestellt. Am Hörhilfegerät 1 ist ein Verstärkungssteller 10 sowie ein Programmwahltaster 12 angebracht. Das Hörhilfegerät 1' weist einen Verstärkungssteller 10' sowie einen Schiebeschalter 11' zur Umschaltung zwischen Mikrofon und Hörspule auf.

[0036] Dadurch, daß nicht jedes der Hörhilfegeräte mit sämtlichen Bedienelementen ausgestattet ist, ist es möglich, die Hörhilfegeräte zu miniaturisieren bei gleichzeitiger Vereinfachung der Handhabung. Außer-

dem steht für die vorhandenen Bedienelemente mehr Platz zur Verfügung, womit diese entsprechend größer und bedienerfreundlicher ausgeführt werden können.

5 Patentansprüche

1. Hörgerätesystem zur binauralen Versorgung mit zwei Hörhilfegeräten (1, 1'), mit Mikrofonen (2, 2'), Signalverarbeitungseinheiten (3, 3') Hörern (4, 4') und Bedienelementen (5, 5', 6, 6'), wobei zwischen den Hörhilfegeräten ein Signalaustausch vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest von einem Bedienelement zum Anpassen des einen Hörhilfegerätes erzeugte Steuersignale (7, 7', 8, 8') auf das zweite Hörhilfegerät übertragbar sind und eine simultane Anpassung der beiden Hörhilfegeräte durch diese Steuersignale und die hörgeräteeigenen Signalverarbeitungseinheiten vorgesehen ist.
2. Hörgerätesystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß beide Hörhilfegeräte die gleichen Bedienelemente aufweisen.
3. Hörgerätesystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Bedienelemente zumindest teilweise auf beide Hörhilfegeräte aufgeteilt sind.
4. Hörgerätesystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Hörhilfegeräte jeweils einen Verstärkungssteller (10, 10') zur separaten Einstellung der Verstärkung aufweisen und weitere Bedienelemente, insbesondere Eingangs-Wahlschalter für Mikrofon oder Hörspule (11') sowie Programmwahltaster (12), nur an einem der beiden Hörhilfegeräte vorhanden sind.
5. Hörgerätesystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß alle Bedienelemente an einem der beide Hörhilfegeräte angebracht sind.
6. Hörgerätesystem nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß durch Programmierung der Hörhilfegeräte festlegbar ist, von welchen Bedienelementen die zum Anpassen des einen Hörhilfegerätes erzeugten Steuersignale auf das zweite Hörhilfegerät übertragbar sind.
7. Hörgerätesystem zur binauralen Versorgung mit zwei Hörhilfegeräten (1, 1'), mit Mikrofonen (2, 2'), Signalverarbeitungseinheiten (3, 3') Hörern (4, 4') und Bedienelementen (5, 5', 6, 6'), wobei zwischen den Hörhilfegeräten ein Signalaustausch vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß nur eines der beiden Hörhilfegeräte Mittel (19) zur Signalverarbeitung aufweist, welche vom Mikrofon dieses

Hörhilfegerätes sowie vom Mikrofon des zweiten Hörhilfegerätes empfangene und an das erste Hörhilfegerät übertragene Audiosignale (20, 20') verarbeiten, und wobei verarbeitete Audiosignale (21, 21') dem eigenen Hörer (4) bzw. nach einer Übertragung verarbeiteter Audiosignale an das zweite Hörhilfegerät diese dem Hörer (4') des zweiten Hörhilfegerätes zuführbar sind.

8. Hörgerätesystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eines der beiden Hörhilfegeräte Mittel (22, 22') zur Vorverarbeitung von Audiosignalen aufweist, in der nur die vom eigenen Mikrofon empfangenen Audiosignale vorverarbeitbar sind.
9. Hörgerätesystem nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eines der beiden Hörhilfegeräte Mittel (23, 23') zur Nachverarbeitung von Audiosignalen aufweist, in der verarbeitete Audiosignale nachverarbeitbar und dem eigenen Hörer zuführbar sind.
10. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Hörhilfegerät, welches die Mittel (19) zur Signalverarbeitung der von beiden Mikrofonen empfangenen Audiosignale aufweist, ohne Bedienelemente oder nur mit einem Teil der Bedienelemente des Hörgerätesystems versehen ist.
11. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Hörhilfegeräte jeweils Sende- und/oder Empfangseinheiten (9, 9') zur Übertragung der Audio- und/oder Steuersignale aufweisen.
12. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Audio- und/oder Steuersignale zwischen den Hörhilfegeräten drahtgebunden übertragbar sind.
13. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Audio- und/oder Steuersignale zwischen den Hörhilfegeräten drahtlos übertragbar sind.
14. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die zwischen den Hörhilfegeräten übertragenen Signale digital sind.
15. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Hörhilfegerät wenigstens eine Telefonspule (13, 13') zur induktiven Aufnahme und/oder Abgabe der Audio- und/oder Steuersignale aufweist.

16. Hörgerätesystem nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Telefonspulen zur Aufnahme magnetischer Nutzsignale vorgesehen sind.

17. Hörgerätesystem nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Telefonspulen zur drahtlosen Programmierung und/oder Fernbedienung der Hörhilfegeräte vorgesehen sind.

18. Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätesystem nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die von den Bedienelementen zum Anpassen des einen Hörhilfegerätes erzeugten Steuersignale (7, 7', 8, 8') auf das zweite Hörhilfegerät übertragen werden und die beiden Hörhilfegeräte durch diese Steuersignale und die hörgeräteeigenen Signalverarbeitungseinheiten simultan angepaßt werden.

19. Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätesystem nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß nur eines der beiden Hörhilfegeräte Mittel (19) zur Signalverarbeitung aufweist und von diesem die vom eigenen Mikrofon empfangenen sowie die vom Mikrofon des zweiten Hörhilfegerätes empfangenen und an das erste Hörhilfegerät übertragenen Audiosignale verarbeitet werden, und wobei verarbeitete Audiosignale dem eigenen Hörer bzw. nach einer Übertragung verarbeiteter Audiosignale an das zweite Hörhilfegerät diese dem Hörer des zweiten Hörhilfegerätes zugeführt werden.

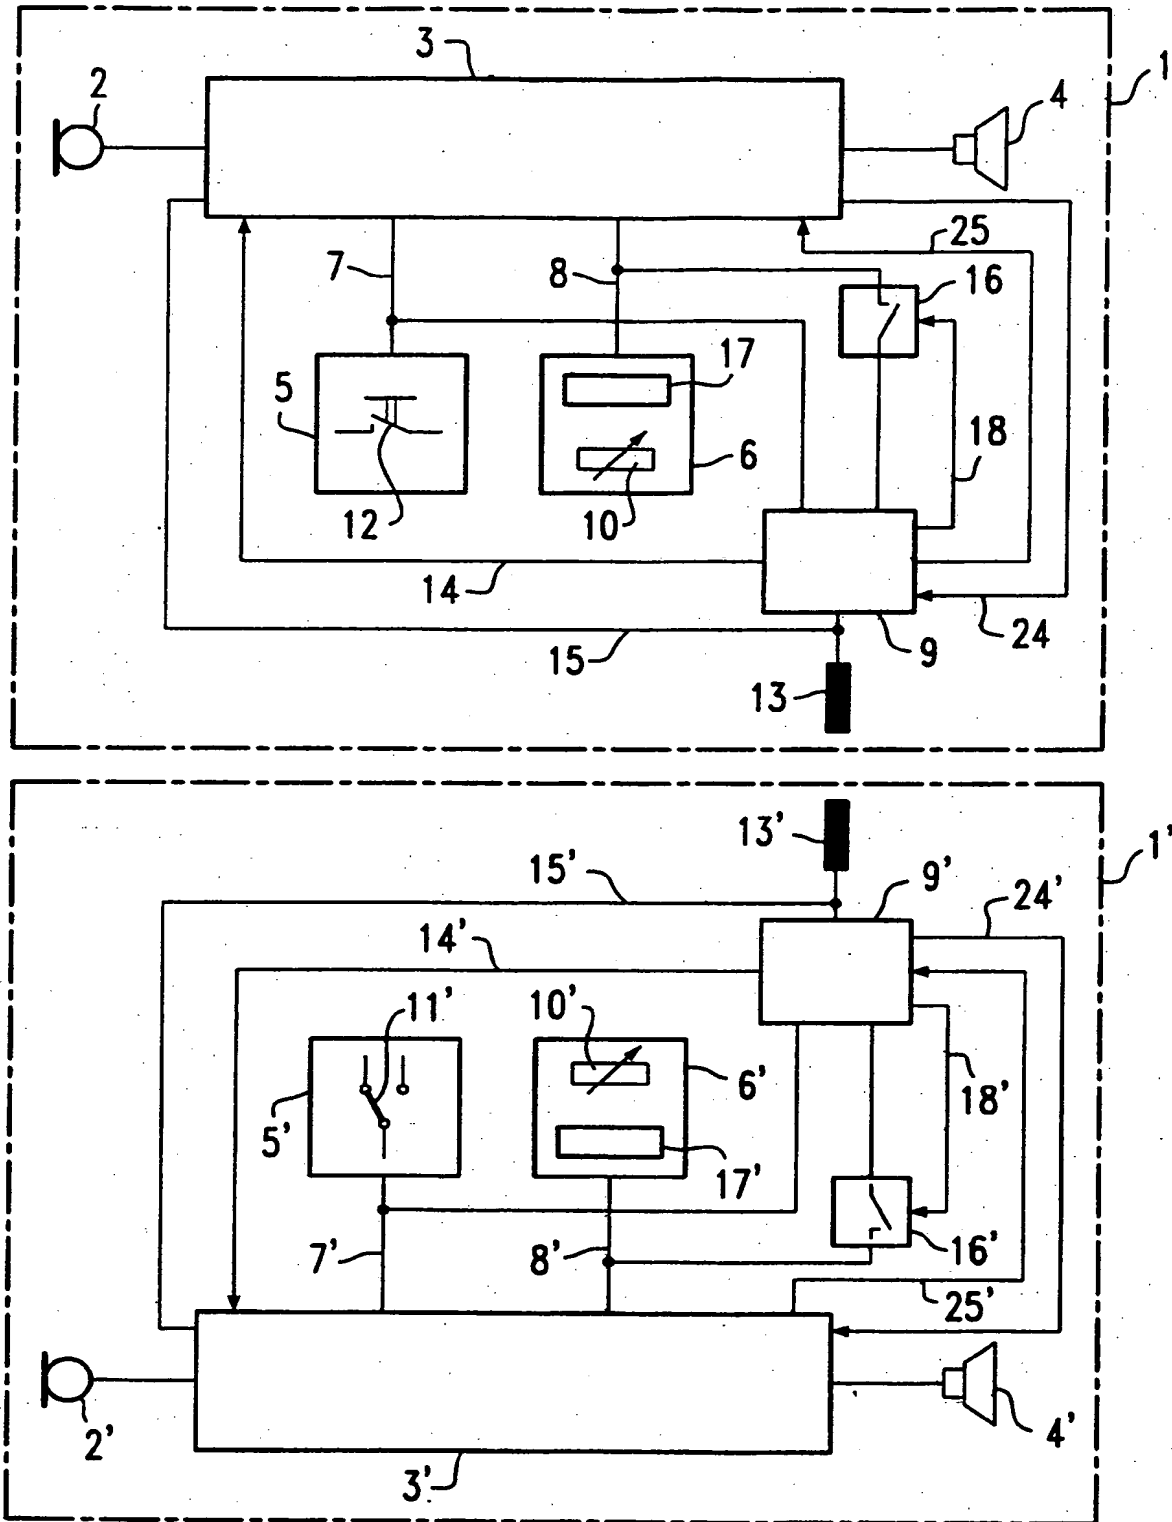


FIG 1




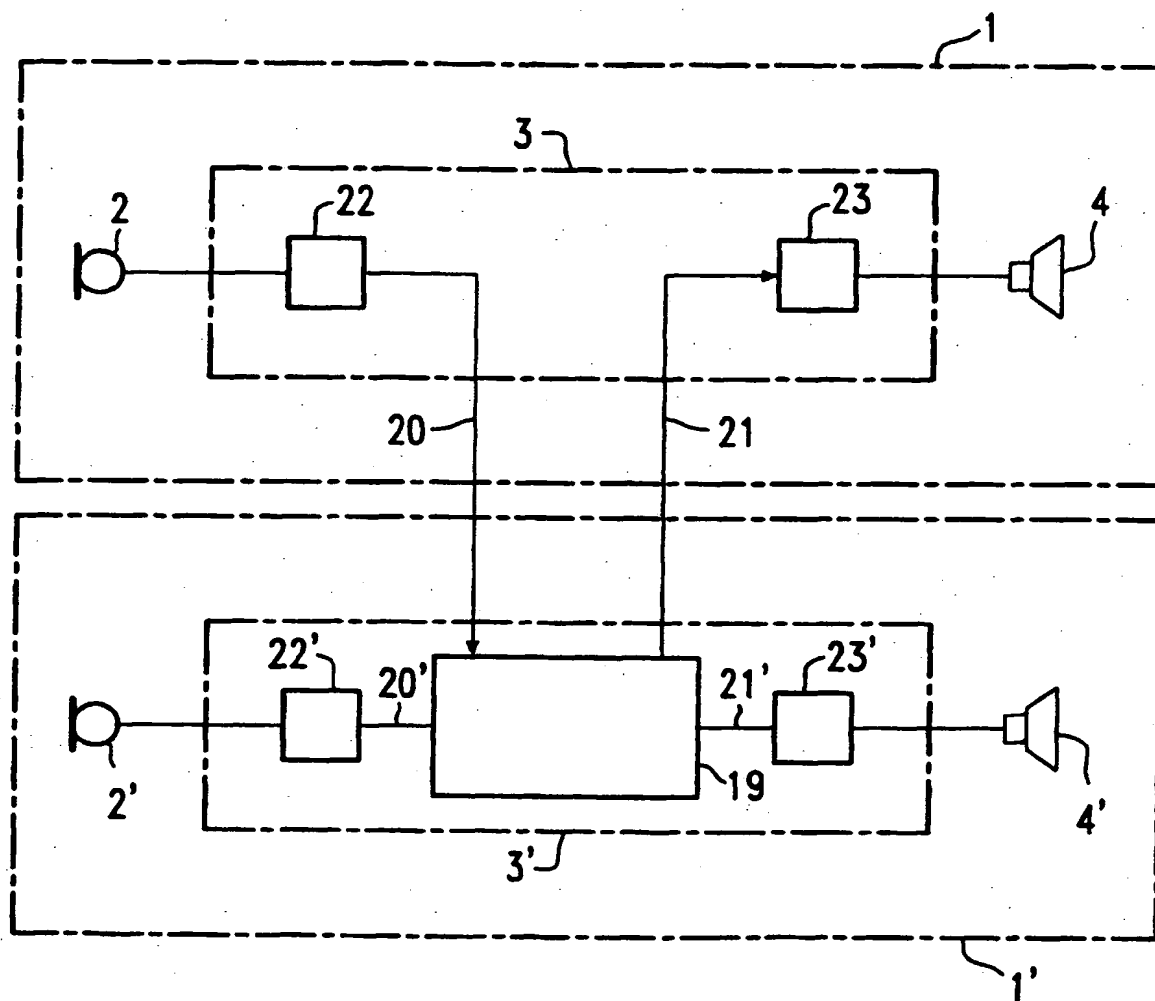


FIG 2

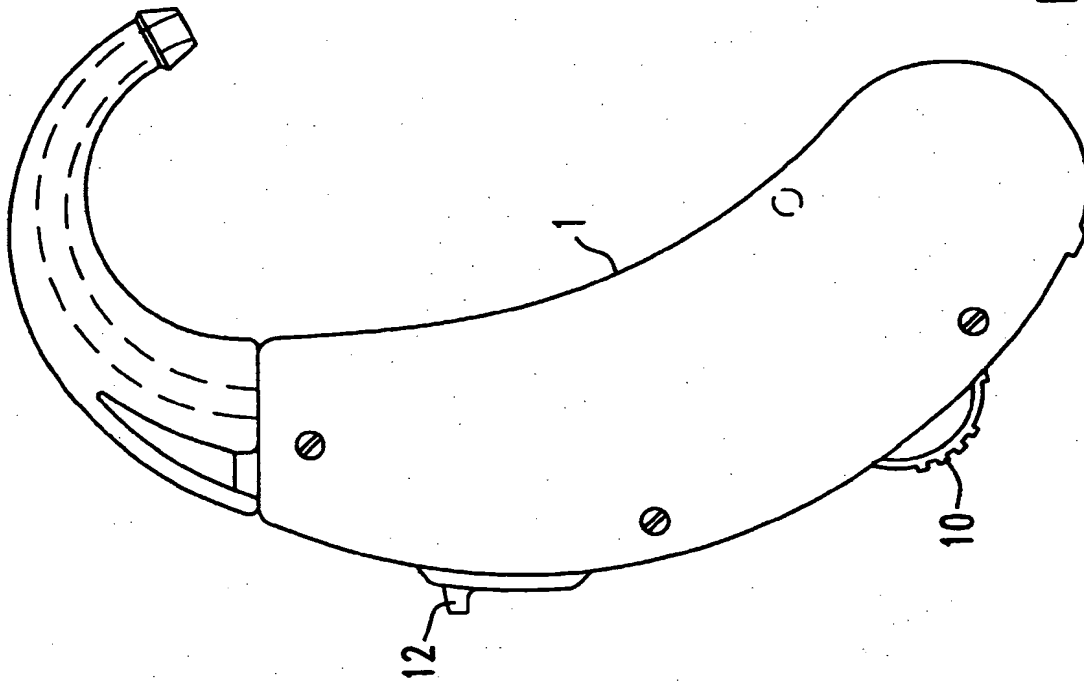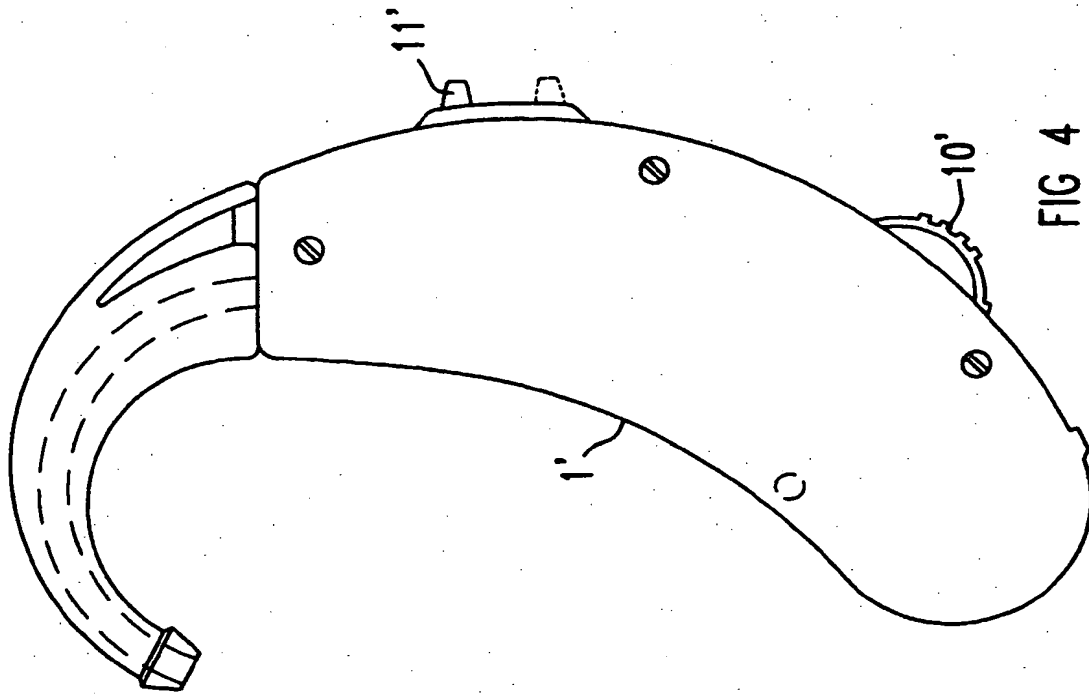



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 941 014 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
18.08.2004 Patentblatt 2004/34

(51) Int Cl.7: H04R 25/00

(43) Veröffentlichungstag A2:
08.09.1999 Patentblatt 1999/36

(21) Anmeldenummer: 99103207.9

(22) Anmeldetag: 18.02.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 03.03.1998 DE 19808996
01.12.1998 DE 19855483
09.02.1999 DE 19905330

(71) Anmelder: Siemens Audiologische Technik
GmbH
91058 Erlangen (DE)

(72) Erfinder:
• Holube, Inga Dr.
91052 Erlangen (DE)

- Meyer, Wolfram Dipl.-Ing.
91096 Möhrendorf (DE)
- Husung, Kunibert Dipl.-Ing.
91052 Erlangen (DE)
- Gebert, Anton Dipl.-Ing.
91077 Kleinsendelbach (DE)
- Sporer, Gerhard Dipl.-Ing.
91207 Lauf (DE)

(74) Vertreter: Berg, Peter, Dipl.-Ing. et al
European Patent Attorney,
Siemens AG,
Postfach 22 16 34
80506 München (DE)

(54) Hörgerätesystem mit zwei Hörhilfegeräten sowie Verfahren zum Betrieb eines solchen Hörgerätesystems

(57) Durch die Betätigung eines Bedienelementes (5, 5', 6, 6') an einem der beiden Hörhilfegeräte (1, 1') des Hörgerätesystems wird ein Steuersignal erzeugt und auf das zweite Hörhilfegerät übertragen, was zu einer simultanen Anpassung der beiden Hörhilfegeräte durch dieses Steuersignal und die hörgeräteeigenen Signalverarbeitungseinheiten führt. Eine weitere Vereinfachung des Hörgerätesystems wird dadurch erreicht, daß Mittel zur Verarbeitung der Audiosignale auf die Hörhilfegeräte verteilt sind.

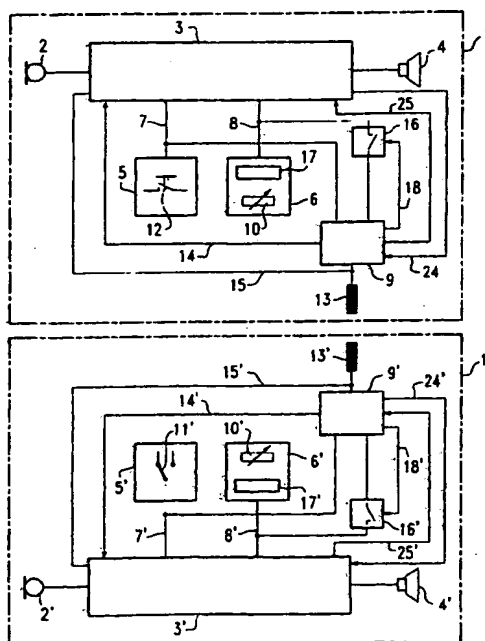


FIG 1

EP 0 941 014 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 10 3207

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	US 5 434 924 A (JAMPOLSKY ARTHUR) 18. Juli 1995 (1995-07-18) * Spalte 9, Zeile 62 - Spalte 10, Zeile 6 * * Spalte 12, Zeile 22 - Spalte 13, Zeile 20 * * Abbildungen 4,5 *	1,3, 11-13,18	H04R25/00 H04R25/00
Y		2	
A		4-6	
P,X	DE 197 04 119 C (SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK) 1. Oktober 1998 (1998-10-01) * Spalte 2, Zeile 26 - Spalte 3, Zeile 64 * * Ansprüche 7,8 * * Abbildung 1 *	1,14	
Y	CH 341 866 A (HOLLINGSWORTH ELEANOR) 31. Oktober 1959 (1959-10-31) * Seite 2, Zeilen 3-6 *	2	
X	WO 97/14268 A (AUDIOLOGIC INC) 17. April 1997 (1997-04-17) * Seite 2, Zeile 5 - Zeile 25 * * Seite 7, Zeile 8 - Seite 10, Zeile 16 * * Abbildungen 2,3,5 *	7-10,19	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) H04R G02C
Y		15-17	
Y	US 5 615 229 A (STROHALLEN GENE M ET AL) 25. März 1997 (1997-03-25) * Spalte 1, Zeile 37 - Zeile 67 * * Spalte 23, Zeile 13 - Zeile 43 * * Abbildung 21 *	15-17	
A	DE 23 60 342 B (SIEMENS) 6. Februar 1975 (1975-02-06) * Spalte 1, Zeile 67 - Spalte 2, Zeile 59 * * Abbildung 1 *	15-17	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 30. Juni 2004	Prüfer Kunzelmann, C
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03.92 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 10 3207

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

30-06-2004

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5434924 A	18-07-1995	AT 59928 T	15-01-1991
		AU 625633 B2	16-07-1992
		AU 1792988 A	06-12-1988
		DE 3861519 D1	14-02-1991
		EP 0349599 A1	10-01-1990
		JP 3012631 B2	28-02-2000
		JP 11262094 A	24-09-1999
		JP 2503499 T	18-10-1990
		JP 2935266 B2	16-08-1999
		WO 8809105 A1	17-11-1988
DE 19704119 C	01-10-1998	DE 19704119 C1	01-10-1998
		CH 692883 A5	29-11-2002
		DK 15198 A	05-08-1998
		US 6148087 A	14-11-2000
CH 341866 A	31-10-1959	KEINE	
WO 9714268 A	17-04-1997	US 5757932 A	26-05-1998
		AU 7248796 A	30-04-1997
		DE 69631781 D1	08-04-2004
		EP 0855130 A1	29-07-1998
		NO 981559 A	08-06-1998
		WO 9714268 A1	17-04-1997
US 5615229 A	25-03-1997	AT 211333 T	15-01-2002
		AU 7252394 A	24-01-1995
		DE 69429516 D1	31-01-2002
		DE 69429516 T2	08-08-2002
		DK 706732 T3	08-04-2002
		EP 0706732 A1	17-04-1996
		WO 9501678 A1	12-01-1995
		US 5568516 A	22-10-1996
		US 5774791 A	30-06-1998
		US 5812598 A	22-09-1998
DE 2360342 B	06-02-1975	DE 2360342 B1	06-02-1975

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

AN: PAT 1999-481234
TI: Hearing aid system for two hearing aids has two hearing aids each with microphone and signal processor and loud speaker with connection link between hearing aids for transmitting signals
PN: EP941014-A2
PD: 08.09.1999
AB: The hearing aid system has two hearing aids each with a microphone, a signal processor and a loud speaker. At least one connection link (2) is provided between the two hearing aids (1a,1b) for transmitting audio, control and/or processed audio signals. The connection link may be wired or wireless. Preferably the signal processing stages of the two hearing aids (1a,1b) are connected via the connection link (2). Several connection links may be provided.; USE - For bi-aural hearing aid systems and digital hearing aids. ADVANTAGE - Allows communication between two hearing aids. Provides better system of normal hearing between left and right ear of hearing impaired.
PA: (SIEI) SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECH GMBH;
IN: GEBERT A; HOLUBE I; HUSUNG K; MEYER W; SPORER G;
FA: EP941014-A2 08.09.1999; EP941014-B1 04.01.2006;
CO: AL; AT; BE; CH; CY; DE; DK; EP; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; LI; LT; LU; LV; MC; MK; NL; PT; RO; SE; SI;
DR: AL; AT; BE; CH; CY; DE; DK; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; LI; LT; LU; LV; MC; MK; NL; PT; RO; SE; SI;
IC: H04R-025/00;
MC: W04-Y; W04-Y03C1A;
DC: W04;
FN: 1999481234.gif
PR: DE1008996 03.03.1998; DE1055483 01.12.1998;
DE1005330 09.02.1999;
FP: 08.09.1999
UP: 11.01.2006

